Temperatura oral con SureTemp® Plus

Modelos 692/690

1. Asegúrese de que la sonda con el botón de eyección azul y el compartimiento de la sonda azul están instalados.
2. Retire la sonda de su compartimiento.
3. Observe el indicador del modo Oral en la pantalla (icono de cabeza parpadeante).

   Si este icono no está parpadeando, pulse el botón Selección de modo hasta que aparezca el icono de una cabeza.
4. Cargue una cubierta para sonda.
5. Coloque la punta de la sonda muy adentro de la cavidad sublingual del paciente según se muestra.
6. No deje que el paciente agarre la sonda con la mano para ponérsela en su boca.
7. Sujete siempre la sonda en su lugar, manteniendo el contacto con el tejido hasta que se haya terminado de medir la temperatura.

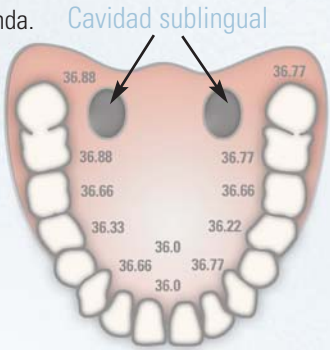

Welch Allyn®

Advancing Frontline Care™

Consejos para tomar la temperatura oral con SureTemp® Plus

1. Siempre deje que el paciente haga las preguntas que tenga antes de colocarle la sonda en la boca. Dígale que no hable mientras el termómetro esté midiendo la temperatura.
2. Informe a su paciente que si muerde la punta de la sonda mientras está midiendo la temperatura, puede dañarse la sonda.
3. Utilice solamente cubiertas desechables para sondas Welch Allyn. Si utiliza cualquier otra cubierta para sonda pueden producirse lecturas de temperatura imprecisas.
4. Si cuestiona una lectura, vuelva a comprobar la temperatura utilizando el modo Monitor de su termómetro. Tome la temperatura oral según lo descrito.
   - > Continúe sujetando la sonda en su lugar después de visualizar la temperatura.
   - > Pulse el botón Selección de modo hasta que aparezca en la pantalla el indicador MONITOR de modo Monitor.
   - > Continúe tomando la temperatura durante aproximadamente tres minutos.
   - > No se recomienda la monitorización continua a largo plazo en ninguno de los modos.

Las actividaedes a continuación pueden interferir con la obtención de lecturas exactas hasta por 20 minutos:

- > Cepillarse los dientes.
- > Comer
- > Fumar
- > Ingestión de líquidos calientes o fríos.
- > Masticar chicle o pastillas de menta
- > Actividades tales como subir escaleras o correr.

Welch Allyn Iberia,
General Varela 35, Planta 2ª, oficina 10-11,
28020 Madrid, España
Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.com

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

© 2007 Welch Allyn. Todos los derechos reservados. SM2552ES RevC